



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.29.541.A № 64818/1

Срок действия до 30 декабря 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Вычислители количества газа ВКГ-3Т

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ИВТ" (ООО "ИВТ"),
г. Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 31879-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

РБЯК.400880.049 РЭ (раздел 7)

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2017 г. № 2907

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

..... 2017 г.

Серия СИ

№ 040197

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Вычислители количества газа ВКГ-3Т

Назначение средства измерений

Вычислители количества газа ВКГ-3Т предназначены для измерений и преобразований выходных сигналов измерительных преобразователей в значения измеряемых параметров газа, и вычислений объема газа, приведенного к стандартным условиям.

Описание средства измерений

Принцип действия вычислителей основан на преобразовании сигналов измерительных преобразователей температуры, давления и объема газа в рабочих условиях в значения соответствующих величин, с последующим определением расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям.

Вычислители количества газа ВКГ-3Т (в дальнейшем - вычислители) предназначены для работы со следующими измерительными преобразователями:

1) счетчиками газа любого принципа действия, имеющие пассивную выходную цепь типа «сухой контакт», формирующую сигнал дискретным изменением сопротивления с частотой не более 16 Гц, или активную выходную цепь, формирующую сигнал с частотой не более 1000 Гц;

2) платиновыми термопреобразователями сопротивления по ГОСТ 6651-2009 с номинальным сопротивлением 100 или 500 Ом и температурным коэффициентом 0,00385 или 0,00391 °C⁻¹ (номинальная статическая характеристика Pt100, Pt500, 100П или 500П);

3) преобразователями избыточного и/или абсолютного давления и разности давлений по ГОСТ 22520-85 с выходным сигналом постоянного тока в диапазоне (4-20) мА.

Вычислители обеспечивают по одному или двум трубопроводам представление текущих, архивных (часовых, суточных, декадных, месячных) и итоговых значений величин на встроенное табло и посредством интерфейса RS232, RS485 или Ethernet (опция по заказу) на внешнее устройство следующих величин:

- объем и расход газа в рабочих и стандартных условиях (температура 293,15 К, давление 0,101325 МПа);
- температура;
- давление;
- условно постоянные параметры (барометрическое давление, плотность газа в стандартных условиях, молярные доли азота и диоксида углерода в составе газа).

Вычислители обеспечивают определение объема и расхода газа, приведенных к стандартным условиям по ГОСТ 31369-2008.

Вычисления коэффициента сжимаемости и плотности газа производятся в соответствии с методом по ГОСТ 30319.2-2015.

Вычислители имеют систему диагностики, обеспечивающую контроль значений измеряемых величин и регистрацию изменений настроечной базы вычислителя.

Хранение архивной, итоговой информации и параметров настройки осуществляется в энергонезависимой памяти вычислителя. Архив вычислителей рассчитан на ретроспективу 1448 часов, 125 суток, 44 декад и 24 месяцев.

Питание вычислителей осуществляется от литиевой батареи напряжение 3,6 В или от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В (опция по заказу).

Вычислители выполнены в пластмассовом ударопрочном корпусе. Конструкция корпуса обеспечивает степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Общий вид вычислителя приведен на рисунке 1.

Места пломбирования вычислителя приведены на рисунке 2.



Рисунок 1 - Общий вид вычислителя

В целях предотвращения несанкционированного доступа к узлам регулировки и настройки и ПО, а также к элементам конструкции, предусмотрены места пломбирования, указанные на рисунке 3.

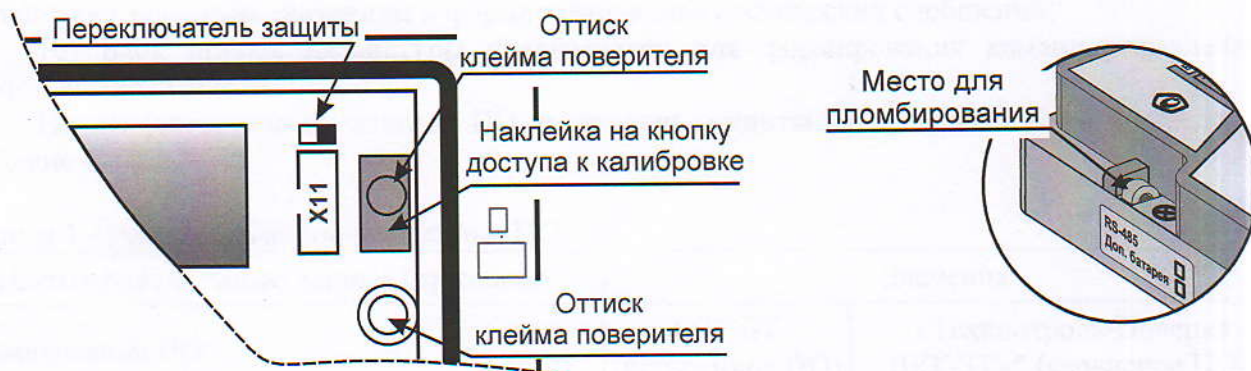


Рисунок 2 - Места пломбирования вычислителя

Программное обеспечение

Вычислители имеют встроенное программное обеспечение (ПО). Структура и взаимосвязи частей ПО показана на рисунке 3.

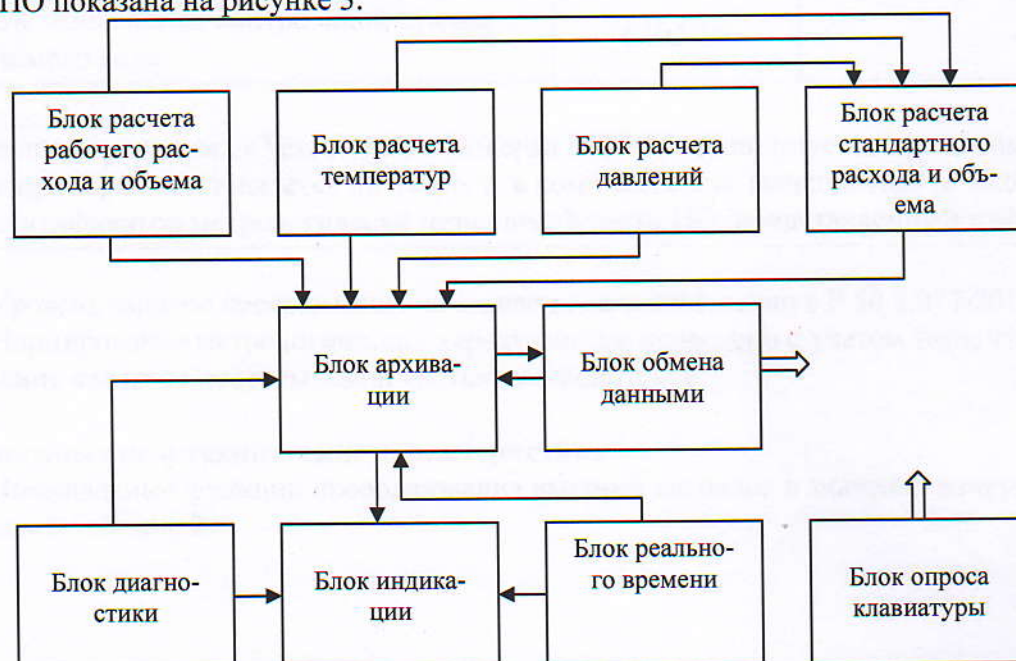


Рисунок 3 - Структура ПО

Основные функции частей программного обеспечения:

- 1) Блок расчета рабочего расхода и объема предназначен для расчетов их значений по результатам измерений выходных сигналов счетчиков;
- 2) Блок расчета температур предназначен для расчетов значений температур и их разности по результатам измерений выходных сигналов термопреобразователей сопротивления;
- 3) Блок расчета давлений предназначен для расчетов их значений по результатам измерений выходных сигналов преобразователей давления;
- 4) Блок расчета стандартного расхода и объема предназначен для расчетов их значений по результатам расчетов рабочих расходов и объемов, температур и давлений;
- 5) Блок архивации предназначен для расчетов и хранения средних и итоговых значений всех измеряемых величин;
- 6) Блок обмена предназначен для вывода через последовательный порт измерительной, диагностической и настроечной информации на внешние устройства приема;
- 7) Блок индикации предназначен для визуального отображения на табло вычислителя измерительной, диагностической и настроечной информации;
- 8) Блок реального времени предназначен для измерения времени работы вычислителя, времени действия диагностируемых ситуаций и ведения календаря;
- 9) Блок диагностики предназначен для контроля значений измеренных параметров на соответствие заданным значениям и формирования диагностических сообщений;
- 10) Блок опроса клавиатуры предназначен для формирования команд управления работой вычислителя.

Идентификационные данные ПО и уровень защиты ПО вычислителей приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значения	
	ВКГ-3Т (встроенное ПО)	«Техконтроль-Поверка ВКГ-3Т»* (сервисное ПО)
Наименование ПО		
Номер версии (идентификационный номер) ПО	ПВ 01.XX	v 1.2 и выше
Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	F614	-
Алгоритм вычисления контрольной суммы исполняемого кода	CRC-16	-

* - сервисная программа «Техконтроль-Поверка ВКГ-3Т» используется при автоматизированной поверке приборов, поставляется по запросу, в комплектность вычислителя не входит.

XX - идентификатор метрологически незначимой части ПО, представленный цифрами от 0 до 9.

Уровень защиты программного обеспечения в соответствии с Р 50.2.077-2014 «высокий».

Нормирование метрологических характеристик проведено с учетом того, что программное обеспечение является неотъемлемой частью вычислителей

Метрологические и технические характеристики

Номинальные функции преобразования входных сигналов в значения измеряемых величин приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Номинальные функции преобразования входных сигналов в значения измеряемых величин

Измеряемая величина	Номинальная функция преобразования
Объем в рабочих условиях, м ³	$V = N \cdot B$
Объем в стандартных условиях, м ³	$V_c = V \cdot C$
Средний объемный расход в рабочих условиях, м ³ /ч	$G = 3600 F \cdot B$
Средний объемный расход в стандартных условиях, м ³ /ч	$G_c = G \cdot C$
Температура газа, °С	Согласно ГОСТ 6651-2009
Давление газа (разность давлений), МПа	$P = P_b (I - 4) / 16 + P_b^*$
* Величина P_b применяется только при измерениях избыточного давления.	

Условные обозначения величин, принятые в таблице 2:

B - вес (цена) импульса счетчика объема, м³/имп.;

$C = P \cdot T_c / P_c \cdot T \cdot K$ - коэффициент коррекции (приведения к стандартным условиям);

I - ток преобразователя давления (разности давлений), мА;

F - частота сигнала счетчика объема, Гц;

G и G_c - расход газа в рабочих и стандартных условиях соответственно, м³/ч;

K - коэффициент сжимаемости газа;

N - количество импульсов, имп.;

P и P_c - абсолютное давление газа в рабочих и стандартных условиях соответственно, МПа;

P_b - верхний предел диапазона измерений преобразователя давления, МПа;

P_b - условно постоянное значение барометрического давления, МПа;

T и T_c - абсолютная температура газа в рабочих и стандартных условиях соответственно, К;

$T = (t + 273,15) \text{ К}$ (t - температура газа, °С);

V и V_c - объем газа в рабочих и стандартных условиях соответственно, м³.

Основные метрологические характеристики приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные метрологические характеристики

Наименование измеряемой величины	Диапазон преобразования	Пределы допускаемых значений погрешности
Температура, °С	от - 40 до + 70	±0,1 °С (абсолютная)
Давление и разность давлений, МПа (кгс/см ²)	от 0 до 1,6 (от 0 до 16)	±0,1 % (приведенная к верхнему пределу измерений)
Расход в рабочих условиях, м ³ /ч	от 0 до 10 ⁶	±0,5 % (относительная)
Объем в рабочих условиях, м ³	от 0 до 10 ⁹	±1 ед. мл. р., м ³ (абсолютная)
Расход в стандартных условиях, м ³ /ч	от 0 до 10 ⁶	±0,05 % (относительная)
Объем в стандартных условиях, м ³	от 0 до 10 ⁹	±0,05 % (относительная)
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени ±0,01 %.		

Основные технические характеристики вычислителей приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Температура окружающего воздуха, °С	от -25 до +50
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, %	95
Напряжение питания, В	3,6
от встроенного литиевого элемента питания	от 187 до 242
от блока питания (переменный ток частотой (50±1) Гц)	

Наименование характеристики	Значение характеристики
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	140
ширина	100
высота	64
Масса, кг, не более	0,75
Средняя наработка на отказ, ч	80000
Средний срок службы, лет	12

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель вычислителя в виде наклейки и на титульный лист эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Кол-во
Вычислитель количества газа	ВКГ-3Т	1
Паспорт	РБЯК.400880.049 ПС	1
Руководство по эксплуатации (Раздел 7 «Методика поверки», утвержденный ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» «20» октября 2016 г)	РБЯК.400880.049 РЭ	1

Поверка

осуществляется по документу РБЯК.400880.049 РЭ (раздел 7 «Методика поверки») «Вычислители количества газа ВКГ-3Т. Руководство по эксплуатации», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» «20» октября 2016 г.

Основные средства поверки:

Стенд СКС6 (регистрационный №17567-09).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на наклейку, защищающую доступ к кнопке «калибровка» на электронном модуле (платы) прибора и крепежный винт защитного каркаса электронного модуля внутри корпуса прибора (рисунок 2).

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к вычислителям количества газа ВКГ-3Т

ТУ 4217-049-15147476-2006 Вычислители количества газа ВКГ-3Т. Технические условия
ГОСТ 30319.2-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ИВТ» (ООО «ИВТ»)

ИНН 7802571001

Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., дом 45

Телефон: 8 800 250-03-03, (812) 600-03-03

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно - исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

Web-сайт: <http://www.vniim.ru>

E-mail: info@vniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от 23.03.2016 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



М.п.

С.С. Голубев

2017 г.